

動作確認チェックシート

検査日	2024年12月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	真空デシケーター	真空ポンプDA-30D付き。		
型式	DVS-250	真空計付属		
メーカー名	アズワン			
機械Ser,No	Lot,No,1808162			
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2		
3		
4		
5		
6		
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 付属DA-30Dで下表示まで減圧、1h後変化無し。
- 真空計大気圧表示は96.4kPa、ダイヤフラムポンプ到達圧力は-92.4kPa。

到達圧力



大気圧

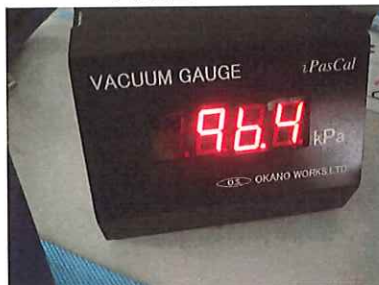

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

