


# 動作確認チェックシート

検査日	2025年2月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	真空ポンプ(ロータリー)	電源電圧	LOW,V100~120/High,V200~240V	
型式	2015SD	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アルカテル	到達真空度	0.011Pa	
機械Ser,No	403406	排気速度	15/18m <sup>3</sup> /h	
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本機単相200V設定、真空計で0.23Pa以下確認1h連続運転。

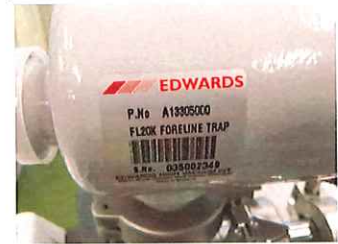

フオワライントラップNG。


真空計と接続



取扱説明書(無)



真空破壊弁別途配線必要。

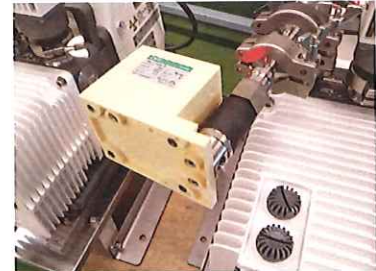

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2025/2/27	オイル交換。	上田

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

