

管理番号

P10575

## 動作確認チェックシート

検査日	2025年 3月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	FFU	電源電圧	AC100V	重量	14.5kg
型式	MAC-II A-100	周波数	50/60Hz		
メーカー名	日本エアーテック	風量	10.0m <sup>3</sup> /min		
機械Ser.No	100-002405-1247	吹出風速	0.51m/sec		
製造年月	-	外寸	W610 D610 H185		


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認を実施。 → 問題なし。
- 2、動作確認 → 問題なし。
  - ①ファンの異音・異臭なし。
  - ②運転表示LED点灯OK。
  - ③パーティクル 0.3μm 0/CF 0.5μm 0/CF。 吹出風速 0.55m/sec。

## 動作確認

## 運転表示LED

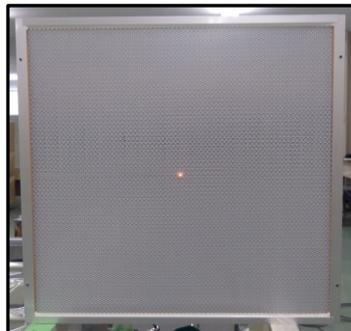

## パーティクル測定中



## パーティクル測定完了



## 吹出風速



取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.5 H ]

検査担当者 [ 佐藤(紀) ]

中野

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日