

# 動作確認チェックシート

検査日	2025/3/25	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源電圧	三相200V 22KW	重量	98Kg
型式	2063	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh(本体)	245x809x385
メーカー名	アルカテル	排気量	917/1080/min	吸気	NW40
機械Ser,No		オイル	7L	排気	NW40
製造年月		到達圧力	0.3Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 1 弊社真空度計で0.23Pa以下を確認、1h連続運転。
- 2 ガスバラス無し。
- 3 オイルミストトラップ無し。

真空計と接続



取扱説明書(無)

ガスバラスト無し

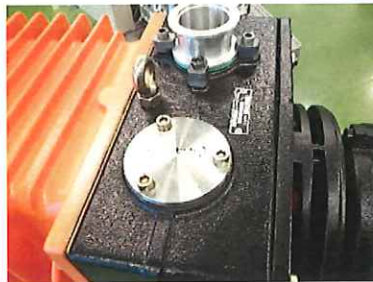

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2.0H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

