

動作確認チェックシート

検査日	2026年1月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボ分子ポンプセット	電源・電圧	単相 200~240V	冷却法	水冷
型式	UTM-800FHA/FTI-800W	周波数	50 / 60 Hz	回転数	36000rpm
メーカー名	アルバック	吸気法兰ジ	VG150	軸受方式	5軸制御磁気軸受
機械Ser.No	XFD0002/ 08211	排気法兰ジ	NW40		
ケーブル	10m	重量	28/10Kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○ ×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

		
•NORMAL時の到達圧力: 9.2×10^{-4}Pa		
<p>* LOCAL運転にて動作確認実施致しました。</p> <p>• STARTにて ACC (加速) 表示し正常に NOR (定常回転) に到達致しました。</p> <p>• STOPにて DEC (減速) 表示し正常に STOP (停止) しました。</p> <p>取扱説明書(無) * 別紙にて加速/ 減速時の写真を添付しております。</p>		

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作 (OK)	作業時間 [3.5H]	
検査担当者 [立野]		
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	







P70272 UTM-800FHA/FTI-800W
回転翼

実施日:2026年1月30日



【LOC ACC～LOC NORまで】
起動時間(NORMAL表示まで 6分32秒)

【LOC DEC～LOC STOPまで】
停止時間(STOP表示まで 10分58秒)

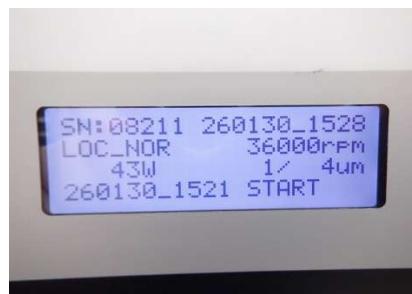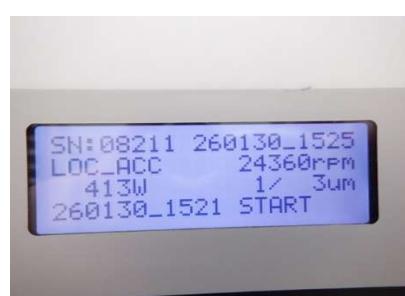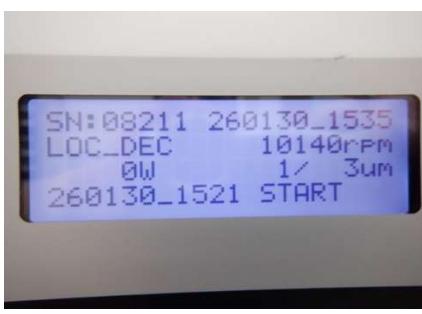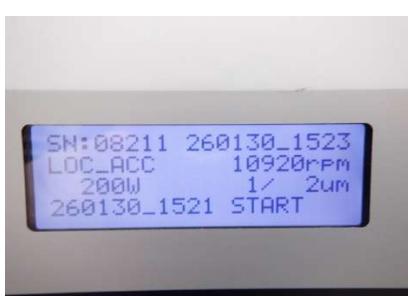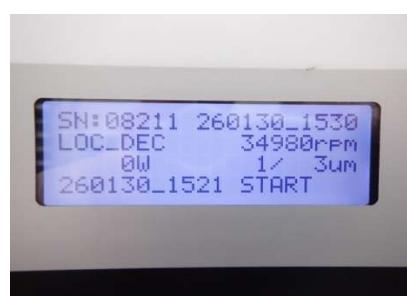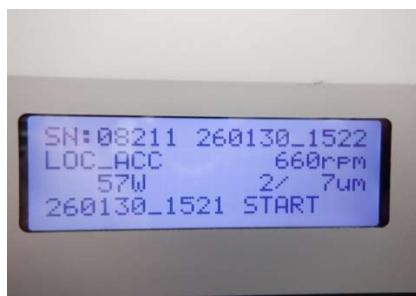

【定常回転に到達】

【正常停止】