

P80363

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2025年12月22日
名称	金属顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	ECLIPSE L300ND
S/N	371150
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	落射式:明視野、暗視野、微分干渉/透過式	鏡筒	三眼鏡筒
		微分干渉ユニット	ANALYZER:L2-AN
照明系	ハロゲンランプ12V 50W		POLARIZER:L2-RPO
総合倍率	50x,100x,200x,500x,1000x	フィルター	ND4/ND16
対物レンズ	LU Plan 5x/0.15 A BD	ステージ	14x12 STAGE
	LU Plan 10x/0.30 A BD	ガラスステージ	397mmx287 mm
	LU Plan 20x/0.45 A BD	ステージストローク	355mmx270 mm
	LU Plan 50x/0.55 A BD		粗動グリッパ
	LU Plan 100x/0.80 A BD	レボルバー	6個穴電動レボルバー
接眼レンズ	CFIUW 10x/25	DSカメラ/DSカメラコントローラ	DS-Fi2/DS-L3

チェック項目


■ コンディション

評価

総合	光学系、メカ系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	X方向少し滑る箇所があるが問題なし。
駆動系	問題なし。
照明	問題なし。
電動レボルバー	問題なし。

取扱説明書:無

視野内画像

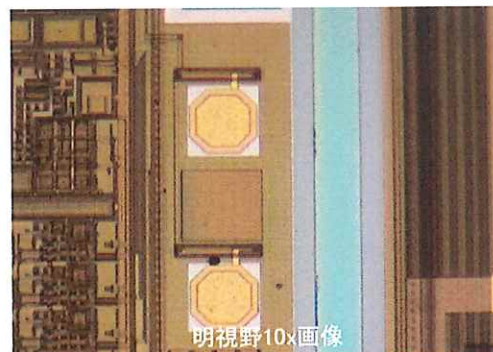

明視野10x画像



明視野10xモニタ画像

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
動作:OK 作業工数[2.5 hr]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[雨宮]



【観察画像・DSカメラコントローラ測定機能】

