


管理No.P90226

測定日:2025.10.01

追加：温湿度推移確認

測定時間：約 1 7 Hr

温湿度計：NZ-THX11-S(オムロン)

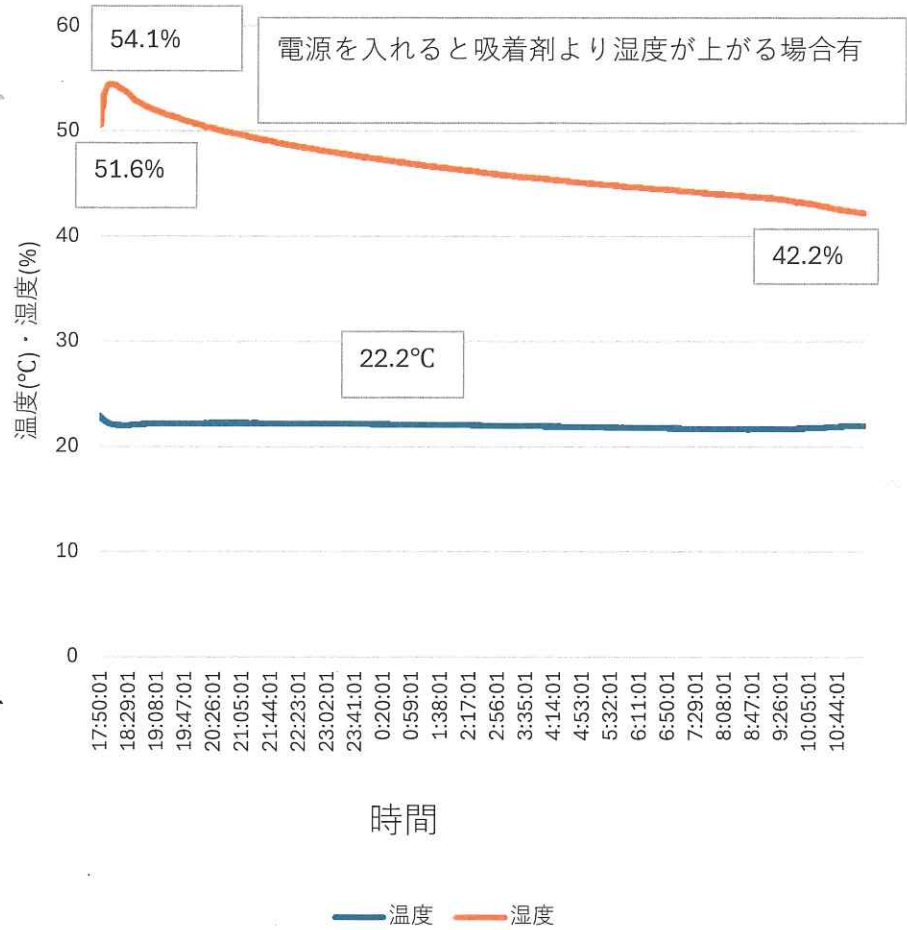

グループ名:センサ

